




1 Local de teste limpo com álcool isopropílico e deixe secar ao ar. Retire a tampa protectora da lanceta segurança.

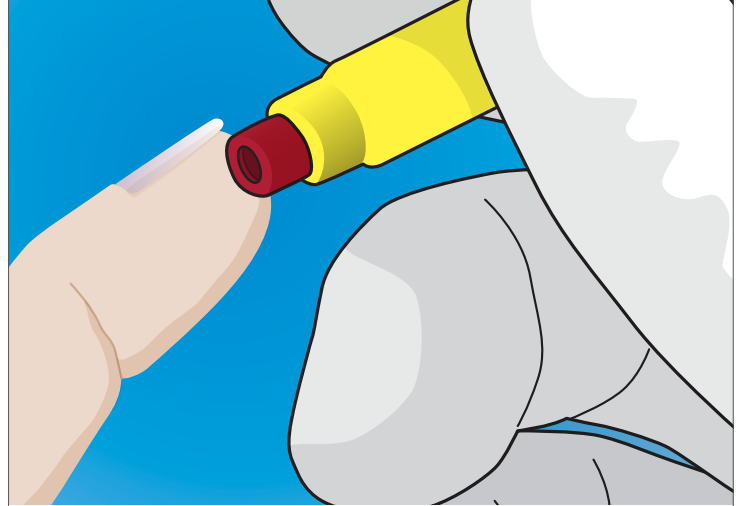

2 Posicionar o vermelho final no local do ensaio.

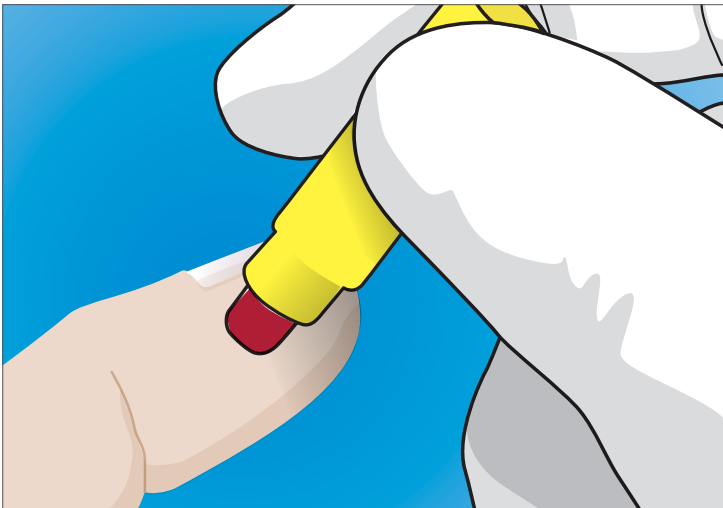

3 Empurre a segurança lancet para baixo contra o site de teste para ativar o mecanismo de lancet.

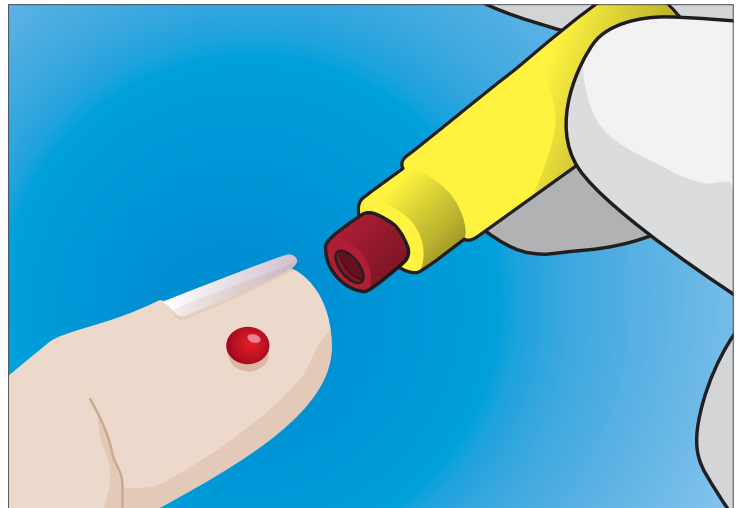

4 Uma vez utilizados, descarte lancet em um recusar contêiner.

medipurpose.com/surgilance/ifu/portugues

MediPurpose™